




KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.

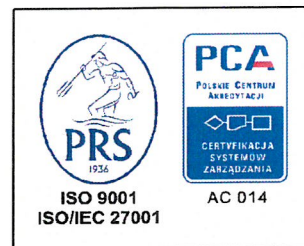

KCZ/ORG/ZM/ *59* /05/2024

Krapkowice 17.05.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę myjni dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - znak sprawy ZO/7/2024

Pytanie 1

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający wymaga aby drzwi były zamykane za pomocą zamka zatrzaskowego bez użycia klamki co daje możliwość zamykania gwarantującego lepsze utrzymanie w czystości oraz bez konieczności każdorazowej dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 2

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było nowe z roku produkcji 2024 co daje pełną gwarancję producenta a także gwarantuje otrzymanie najnowocześniejszych rozwiązań.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenie było nowe, rok produkcji 2023/2024.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjąca była wyposażona w minimum potrójny stopień filtracji roztworu roboczego zabezpieczający przed dostaniem się do instalacji obiegowej drobnych zabrudzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie komunikowało o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień? Takie rozwiązanie gwarantuje prawidłową pracę układu suszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia było nie większe niż 20 litrów? Takie rozwiązanie gwarantuję oszczędność zużycia wody uzdatnionej a w następstwie ograniczenie kosztów eksploatacji myjni.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga aby nastawa pomp dozujących odbywała się w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby dostęp do menu serwisowego urządzenia był z poziomu panela sterującego bez konieczności podłączania komputera w celu dokonania zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby hasło dostępowe do dokonania zmian w programach było stałe a nie zmienne dobowe, które posiada tylko autoryzowany serwis? Takie rozwiązanie w przyszłości gwarantuje możliwość dokonywania zmian przez użytkownika a także dowolnej zmiany np. technologii mycia bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby system dokowania wózka odbywał się za pomocą elementów trwałych wykonanych np. poliamid a nie elastycznej uszczelki narażonej na uszkodzenie podczas załadunku myjni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Z poważaniem

Prokurent
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Violetta Wilk

Do wiadomości:

1. A/a
2. strona www.kcz.krapkowice.pl